



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Πολύγυρος: 28/8/2024  
Αρ. πρωτ. 9008


ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληρ: Παναγιωτίδου Δέσποινα  
Τηλ: 23713 50207  
Email:gnxpanagdespoina@  
1157.syzefxis.gov.gr

Προς : Κάθε Ενδιαφερόμενο

**ΘΕΜΑ :** Αποτελέσματα πρώτης (1<sup>ης</sup>) διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Αυτόματους Αιματολογικούς Αναλυτές, Αναλυτές Αιμόστασης και Τ.Κ.Ε. με Παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού» (CPV 38434520-7), για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής.

Το Γ.Ν. Χαλκιδικής, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της πρώτης (1<sup>ης</sup>) διαβούλευσης, επί των Τεχνικών Προδιαγραφών, σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Αυτόματους Αιματολογικούς Αναλυτές, Αναλυτές Αιμόστασης και Τ.Κ.Ε. με Παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού» (CPV 38434520-7), για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, όπως αυτές υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό 2024ΔΙΑΒ28861.

Συνημμένα:  
Σχόλια Οικονομικού φορέα

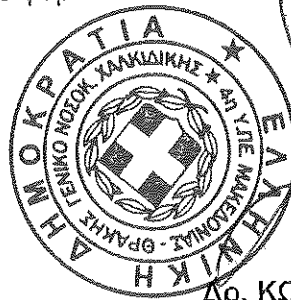

Ο Διοικητής  
του Γ.Ν. Χαλκιδικής

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1<sup>ης</sup> ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ  
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

Δημοσιεύθηκε 12-8-2024

Ημερομηνία Λήξης 27-8-2024

ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Α.Ε.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1<sup>ης</sup> ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΑΝΑΛΥΤΩΝ , ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Τ.Κ.Ε. ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ**

ΑΦΟΡΑ: ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - Διαβούλευση για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Αυτόματους Αιματολογικούς Αναλυτές, Αναλυτές Αιμόστασης και Τ.Κ.Ε. με Παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού»

ΜΕ Αρ. πρωτ. : 8442

**ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕ  
ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ**

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ Τ.Κ.Ε**

Η προδιαγραφή 1 ζητά : Τα σωληνάρια θα πρέπει να είναι άθραυστα από πλαστικό έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μόλυνσης του χειριστή κατά την χρήση τους.

Σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται προσπάθεια για μείωση στην χρήση του πλαστικού για περιβαλλοντικούς σκοπούς. Τα γυάλινα σωληνάρια υψηλής αντοχής έχουν υψηλότερη καθαρότητα και χαμηλό δείκτη διάθλασης σε σχέση με το πλαστικό δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα . Για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού και την συμμετοχή περισσότερων εταιρειών που παρέχουν αξιόπιστα και πιστοποιημένα προϊόντα προτείνουμε να αποδειχτεί την ελάχιστη τροποποίηση της προδιαγραφής ως κατωτέρω:

Τα σωληνάρια θα πρέπει να είναι από πλαστικό ή από γυαλί υψηλής καθαρότητας και αντοχής έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μόλυνσης του χειριστή κατά την χρήση τους.

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ.Κ.Ε**

Η προδιαγραφή 1 ζητά : Το σύστημα μέτρησης της Ταχύτητας Καθίξης Ερυθρών (ΤΚΕ) θα πρέπει να εξασφαλίζει ασφάλεια , ευκολία στη χρήση, αξιοπιστία και ταχύτητα λήψης των αποτελεσμάτων της ΤΚΕ.

Ο μεγάλος όγκος των δειγμάτων που υπάρχουν στα εργαστήρια και των δυο νοσοκομείων δημιουργεί την ανάγκη για έναν αναλυτή Random Access, συνεχούς φόρτωσης για νοσοκομειακή χρήση ώστε να εξοικονομείται χρόνος ανάλυσης. Για τον παραπάνω λόγο προτείνετε η προδιαγραφή να γίνει :

Το σύστημα μέτρησης της Ταχύτητας Καθίξης Ερυθρών (ΤΚΕ) θα πρέπει να εξασφαλίζει ασφάλεια , ευκολία στη χρήση, αξιοπιστία και ταχύτητα λήψης των αποτελεσμάτων της ΤΚΕ καθώς και ο αναλυτής να αποτελεί πλήρες σύστημα Random Access, συνεχούς φόρτωσης για νοσοκομειακή χρήση ώστε να εξοικονομείται χρόνος ανάλυσης

Η προδιαγραφή 7 ζητά : Να υπάρχει η δυνατότητα (προαιρετικά) αυτόματης θερμοκρασιακής αναπροσαρμογής αποτελεσμάτων ( διόρθωση κατά Manley )

Προτείνεται να διαγραφεί η λέξη (προαιρετικά ) διότι η διόρθωση κατά Manley πρέπει να γίνεται . Η προδιαγραφή προτείνεται να γίνει :

Να γίνεται αυτόματη θερμοκρασιακή αναπροσαρμογή των αποτελεσμάτων ( διόρθωση κατά Manley )

Η προδιαγραφή 12 ζητά : Ο προσφερόμενος αναλυτής να είναι τουλάχιστον 25 θέσεων.

Εφόσον ο αναλυτής είναι σύστημα, συνεχούς φόρτωσης , Random Access , αρκεί ένα σύστημα 20 θέσεων για να καλυφθούν οι ανάγκες του νοσοκομείου ( δηλαδή 40 τεστ ανά ώρα ) Για την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού και την συμμετοχή περισσότερων εταιρών εταιρειών που παρέχουν αξιόπιστα και πιστοποιημένα προϊόντα προτείνουμε η συγκεκριμένη προδιαγραφή να γίνει :

Ο προσφερόμενος αναλυτής να είναι τουλάχιστον 20 θέσεων.

Προτείνεται να προστεθεί η παρακάτω προδιαγραφή για την ασφαλέστερη και καλύτερη λειτουργία του εργαστηρίου :

Η προδιαγραφή 19 να ζητά : 8. Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή και αναγνώστη bar code, ενσωματωμένη οθόνη και πληκτρολόγιο.

Η προδιαγραφή 20 να ζητά : 13. Να υπάρχουν υλικά ποιοτικού ελέγχου του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και ο αναλυτής να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου. Επίσης με την χρήση των ίδιων control να είναι δυνατός ο on line Έλεγχος Ποιότητας των αποτελεσμάτων με ειδικό λογισμικό που να δίνει συγκριτικά αποτελέσματα και αναφορές με άλλα εργαστήρια δηλαδή διεργαστηριακός έλεγχος .

Με εκτίμηση,

ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΕ