



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Πολύγυρος: 27-1-2025
Αρ. πρωτ. 1054

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ. Κωνσταντινιά Καμήλαλη
Τηλ: 23713 50207
Email: kamilalik@1157.syzefxis.gov.gr

Προς :
Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα διαβούλευσης με αρ. **2025DIAB29708** επί των Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν την προμήθεια **«ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΕΤ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΥ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ» (CPV:33100000-1)** για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, προϋπολογιστικής δαπάνης **14.880,00** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% ενόψει της κατάρτισης φακέλου για την τελική πρόταση για ένταξη στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027.


Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής ανακοινώνει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών σχετικά με την προμήθεια **«ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΕΤ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΥ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ» (CPV:33100000-1)** για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, προϋπολογιστικής δαπάνης **14.880,00** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% ενόψει της κατάρτισης φακέλου για την τελική πρόταση για ένταξη στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027 όπως αυτά υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό **2025DIAB29708** από τις **10-1-2025** έως τις **25-1-2025**

Συνημμένα :

Σχόλια των Οικονομικών φορέων

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ

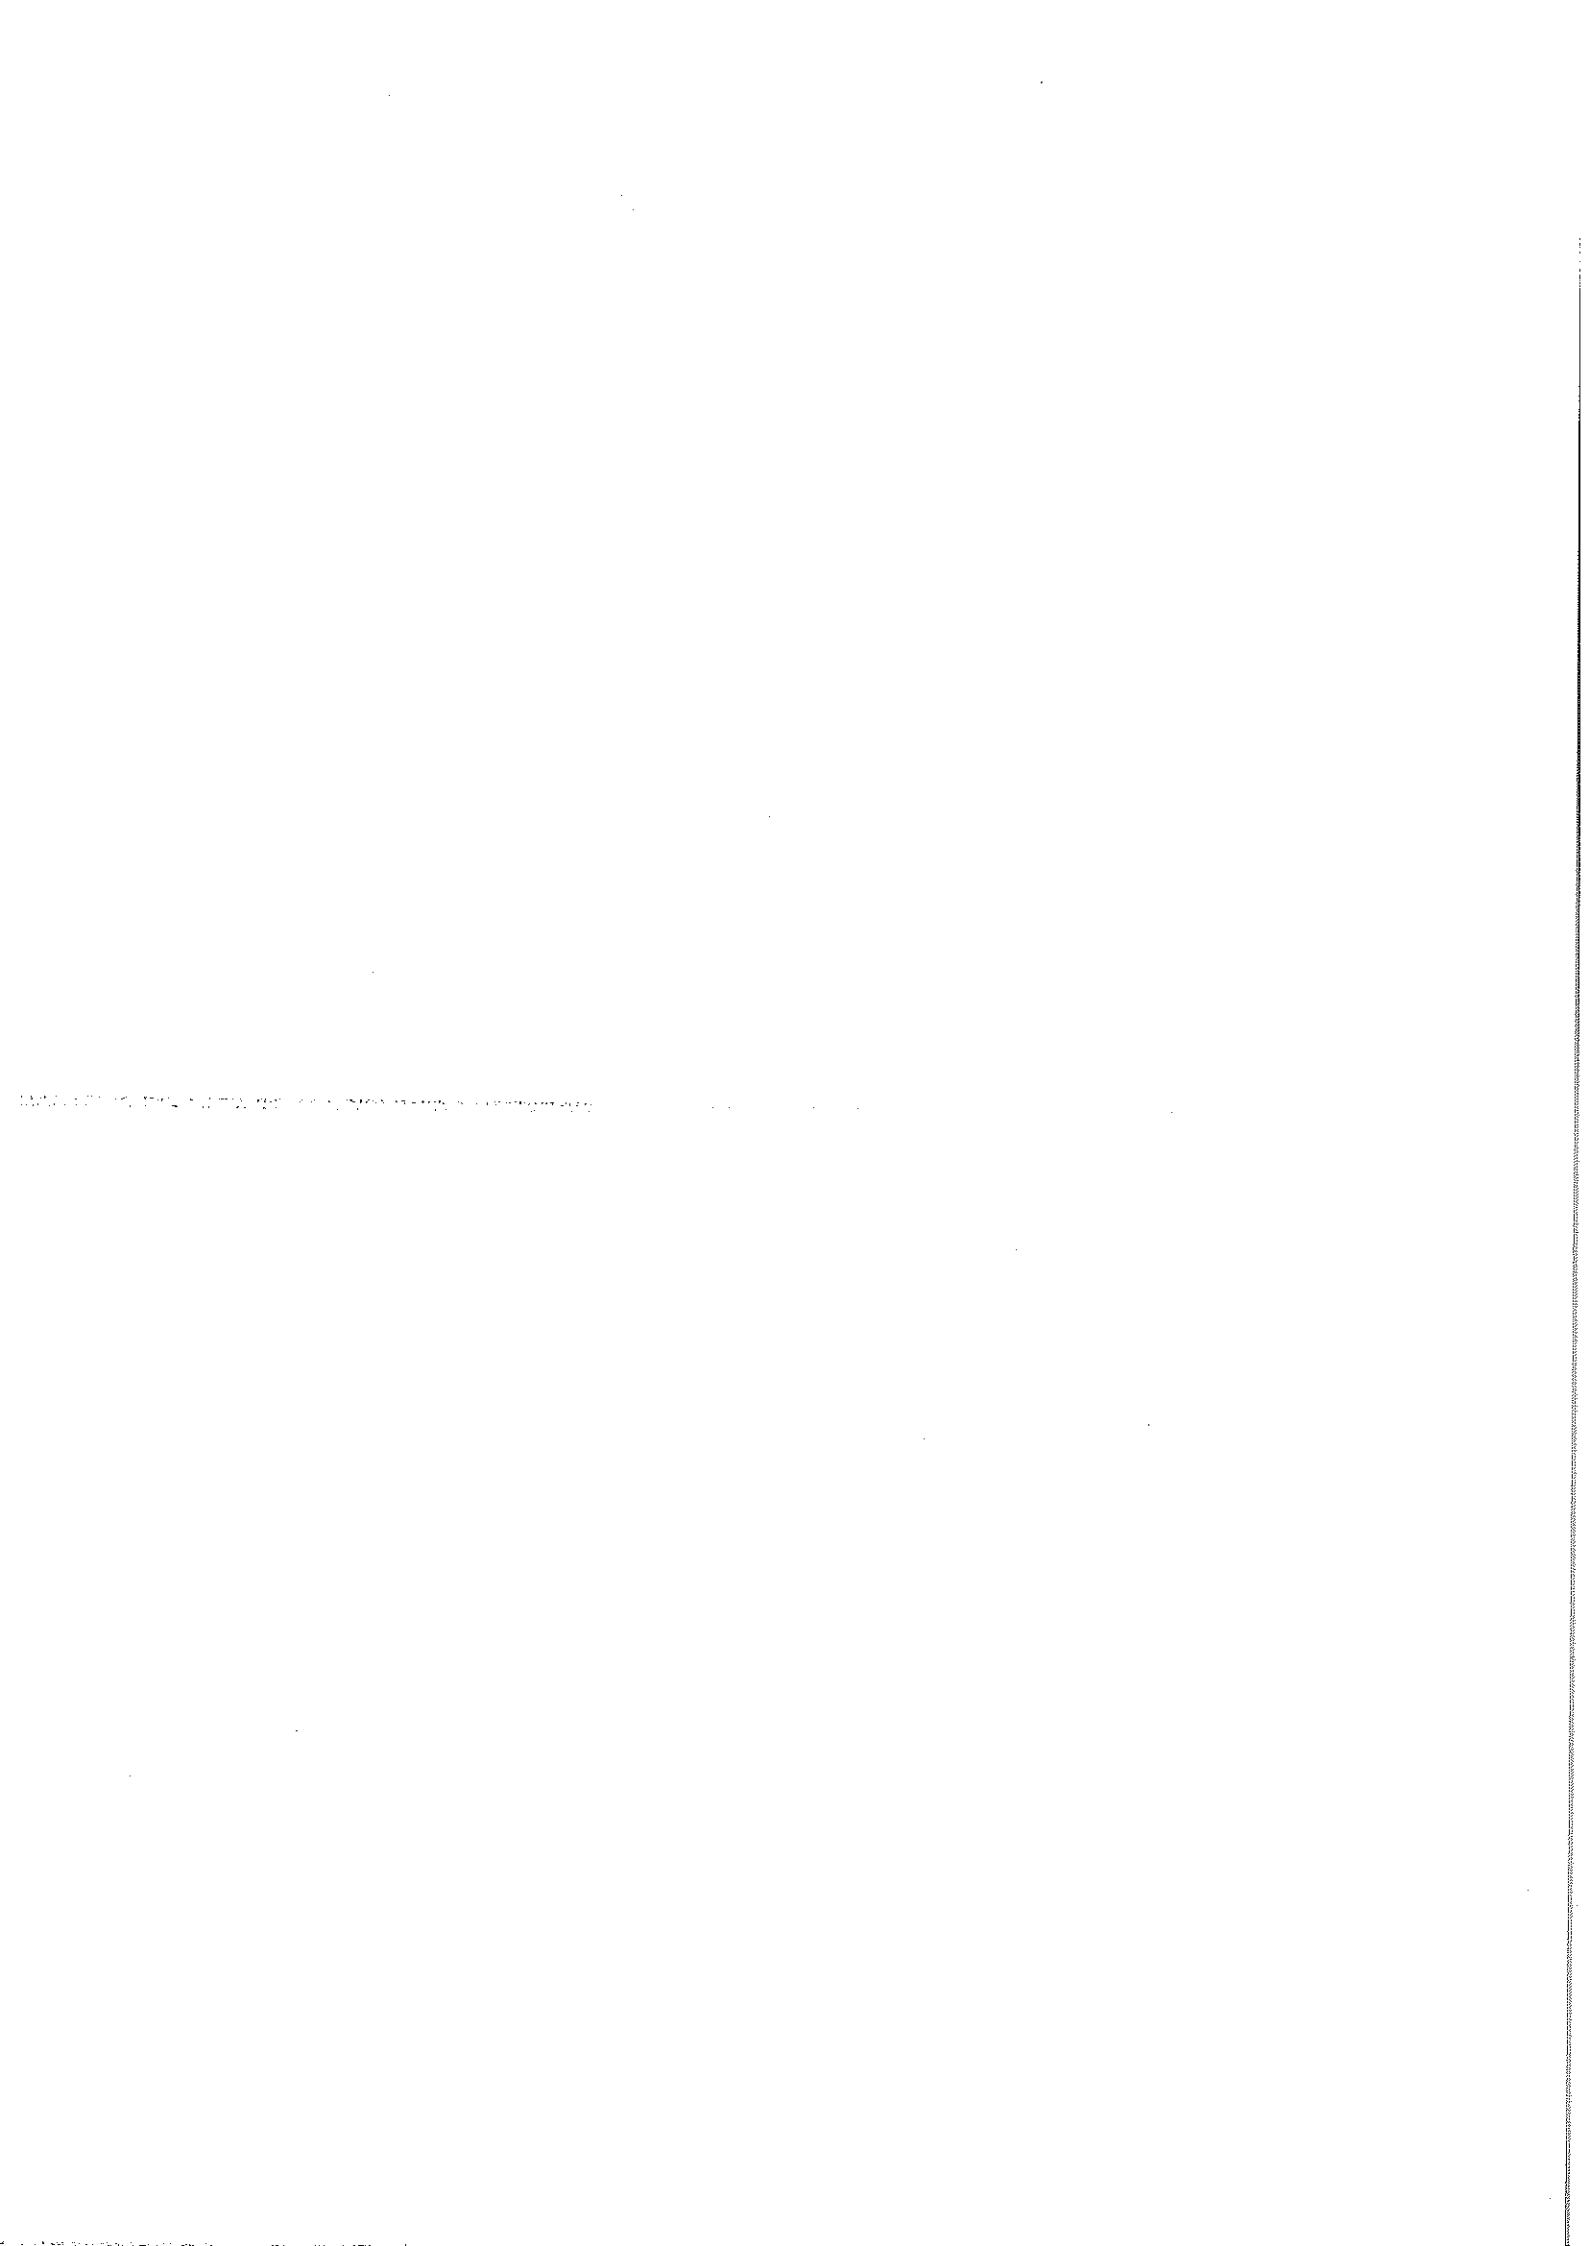

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΕΤ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΥ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ»

1. ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ

Προς
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ.: LT-0000015722

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2025

Θέμα: Σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών Δημόσιας Διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΕΤ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΥ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ» (CPV:33100000-1) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής (2025ΔΙΑΒ29708)

Αξιότιμοι κύριοι,

Καταθέτουμε σχόλια της εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΩΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, επί των τεχνικών προδιαγραφών τεχνικών προδιαγραφών Δημόσιας Διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΕΤ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΥ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ» (CPV:33100000-1) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής (2025ΔΙΑΒ29708), ως εξουσιοδοτημένος διανομέας στην Ελλάδα για τον Ιατρικό Εξοπλισμό και Υλικά κατασκευής του Οίκου OLYMPUS Medical Systems Corporation και των συνεργαζόμενων εταιρειών, ως ακολούθως:

Λόγω του γεγονότος ότι ο ουρηθροτόμος OTIS δεν αποτελεί μέρος του ρεζεκτοσκοπίου, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής "1.2 Να προσφερθούν δύο καλώδια διαθερμίας για σύνδεση του ρεζεκτοσκοπίου με την υπάρχουσα διαθερμία, ένα οπτικό μαντρέν, μια θήκη τοποθέτησης εργαλείων με καπάκι για αποστείρωση σε κλίβανο ατμού και έναν τυφλό ουρηθροτόμο OTIS." ως κάτωθι: "1.2 Να προσφερθούν δύο καλώδια διαθερμίας για σύνδεση του ρεζεκτοσκοπίου με την υπάρχουσα διαθερμία, ένα οπτικό μαντρέν, και μια θήκη τοποθέτησης εργαλείων με καπάκι για αποστείρωση σε κλίβανο ατμού."

Με εκτίμηση
Σμαράγδα Τάτση
Sales Specialist
Surgical Products
OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS

