



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Πολύγυρος:24-1-2025
Αρ. πρωτ. 1.021

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ. Κωνσταντινιά Καμήλαλη
Τηλ: 23713 50207
Email: kamilalik@1157.syzefxis.gov.gr

Προς :
Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα διαβούλευσης με αρ. **2025DIAB29686** επί των Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν την Προμήθεια δύο «**ΨΥΓΕΙΩΝ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑΣ 1) >300 lt και 2) >650lt**»(CPV:50421000-2)για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής συνολικής Προϋπολογιστικής Δαπάνης **4.960,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% ενόψει της κατάρτισης φακέλου για την τελική πρόταση για ένταξη στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027.


Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής ανακοινώνει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών σχετικά με την προμήθεια δύο «**ΨΥΓΕΙΩΝ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑΣ 1) >300 lt και 2) >650lt**»(CPV:50421000-2)για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής συνολικής Προϋπολογιστικής Δαπάνης **4.960,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% ενόψει της κατάρτισης φακέλου για την τελική πρόταση για ένταξη στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027όπως αυτά υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό **2025DIAB29686** από τις **7-1-2025** έως τις **22-1-2025**

Συνημμένα :

Σχόλια των Οικονομικών φορέων

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ

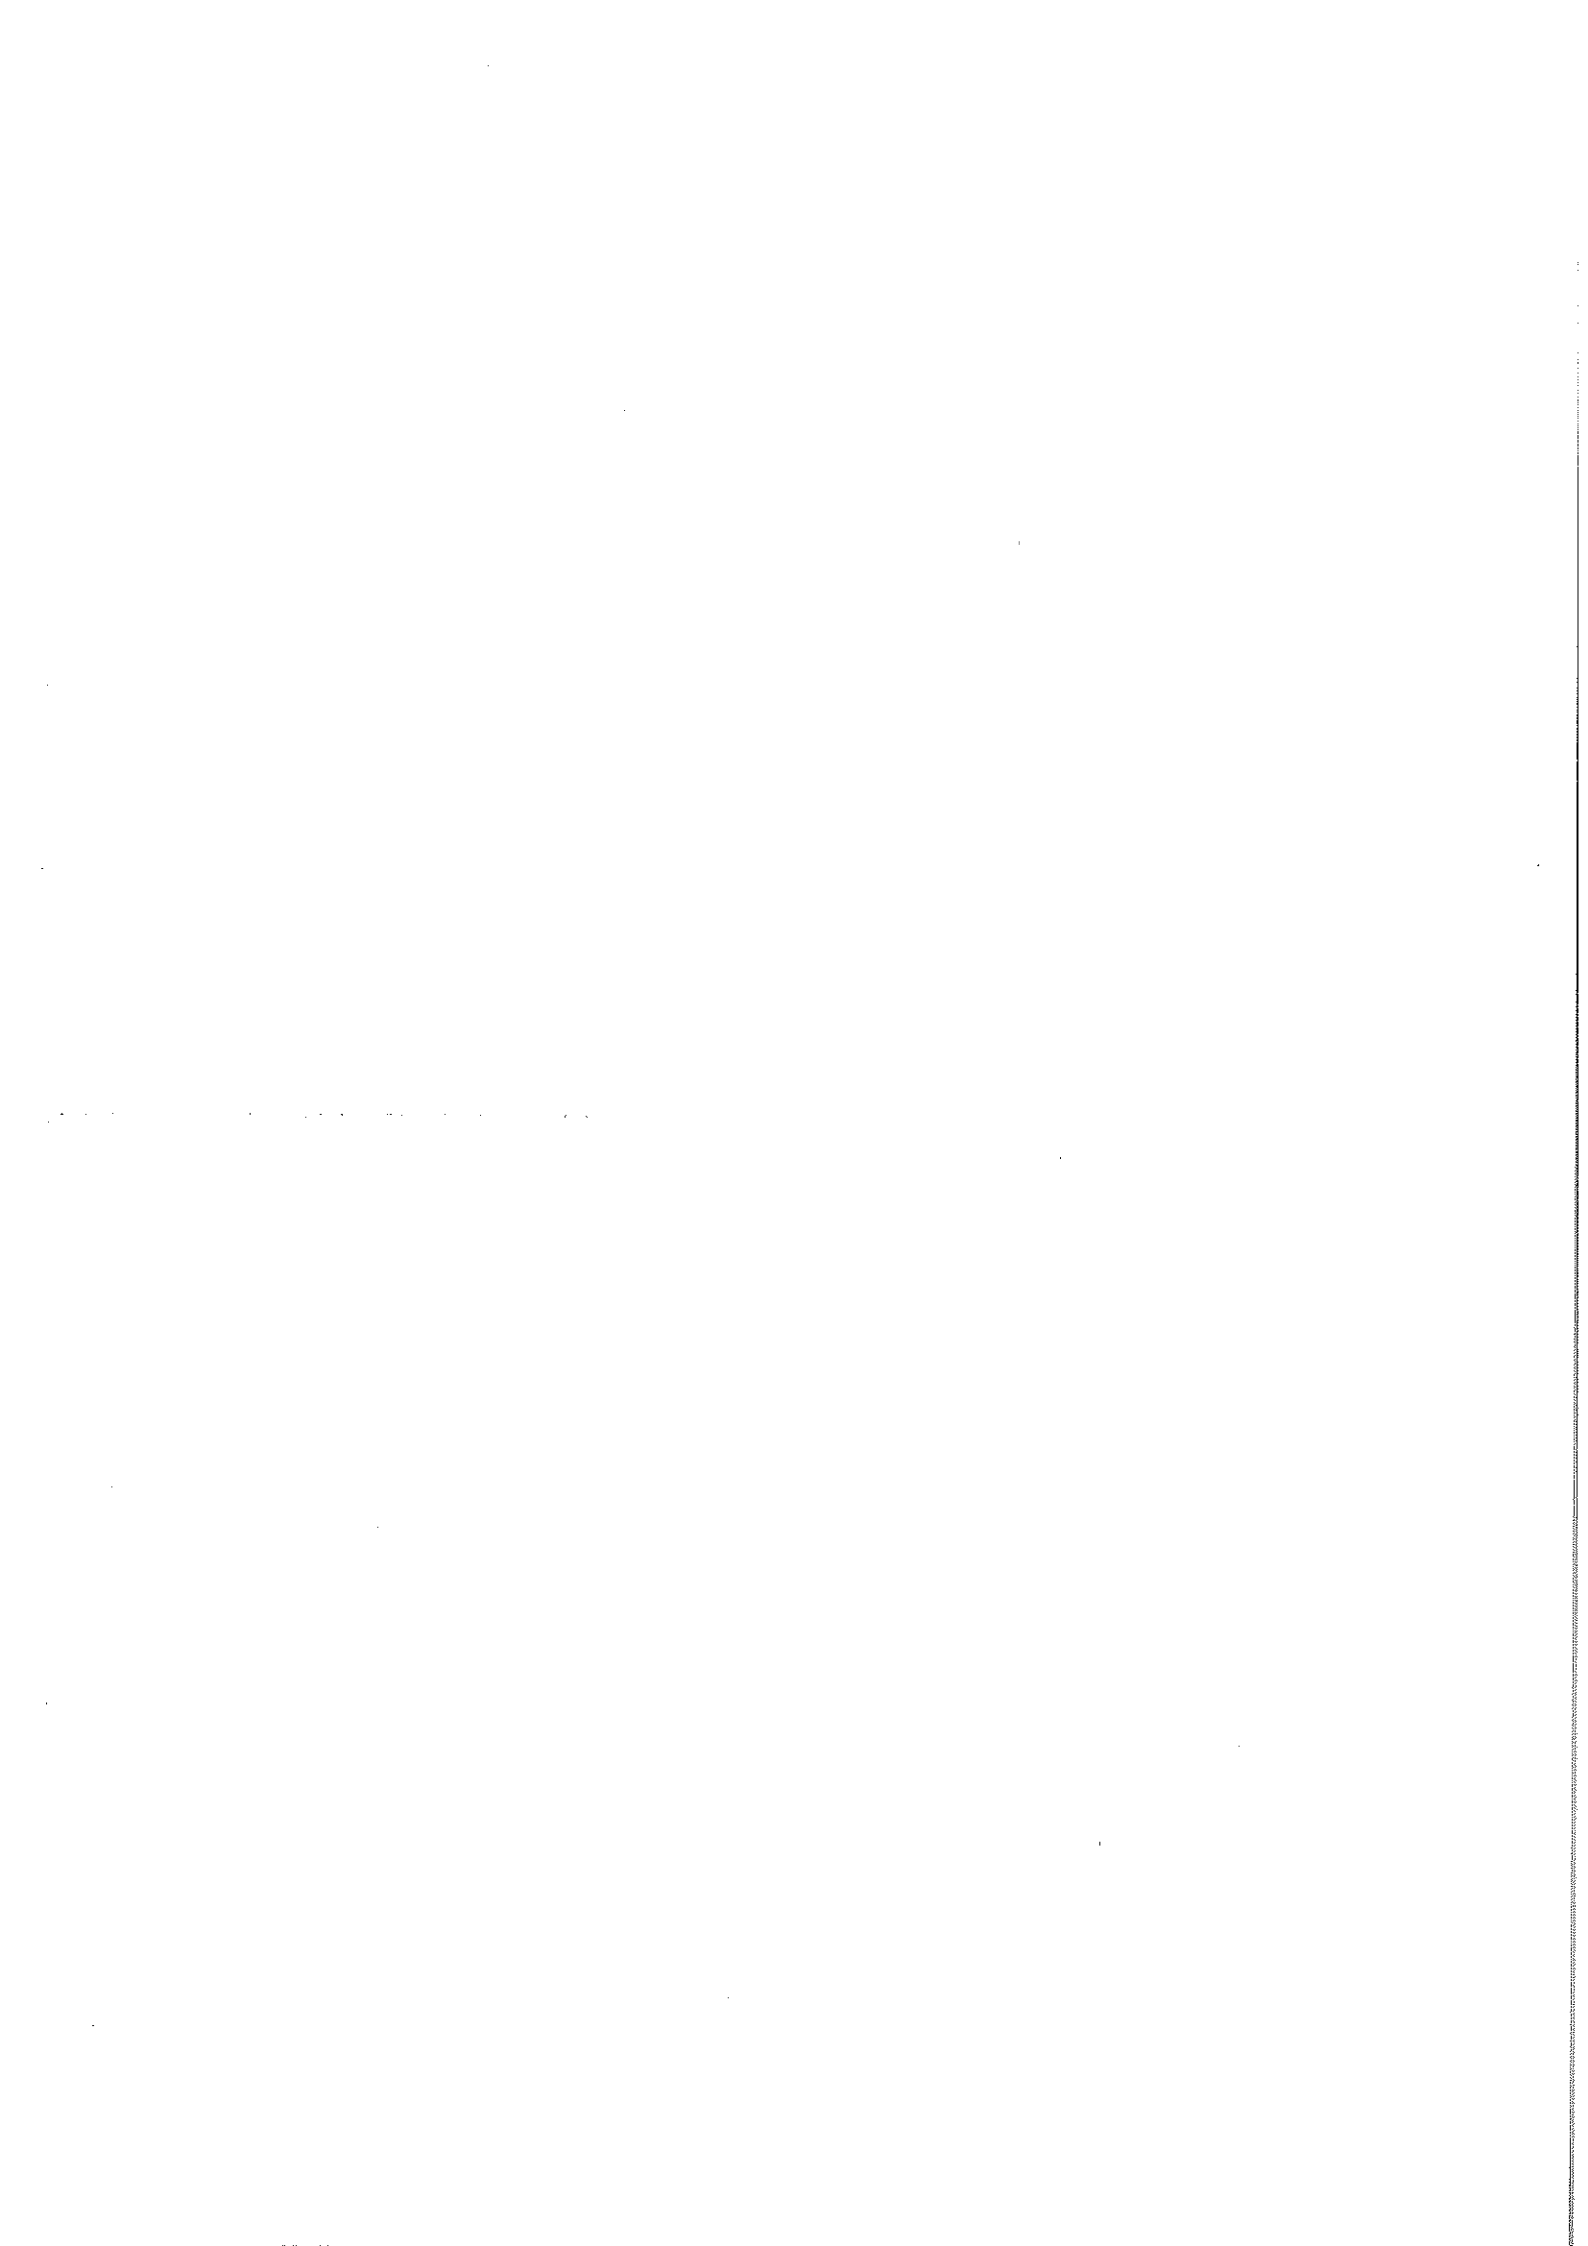

ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

1. ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αξιότιμοι κκ!

Κατόπιν ανάγνωσης των προδιαγραφών της Διαβούλευσης για την προμήθεια δύο «ΨΥΓΕΙΩΝ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑΣ 1) >300 lt και 2) >650lt », Μοναδικός Κωδικός 2025DIAB29686, προτείνουμε τις παρακάτω τροποποιήσεις και βελτιώσεις ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, με ταυτόχρονη διατήρηση της ποιότητας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΩΝ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

2. Να είναι ωφέλιμης χωρητικότητας >300 lt +/- 10% για μονόπορτο και >650 lt +/- 10% για μονόπορτο ή δίπορτο και να διαθέτει ρόδες μετακίνησης βαρέως τύπου με ρεγουλατόρους, ώστε να δύναται να μετακινηθεί εντός του χώρου που ευρίσκεται, και να ρυθμίζεται η κλίση του.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Να είναι ωφέλιμης χωρητικότητας >400 lt +/- 10% για μονόπορτο και >650 lt +/- 10% για μονόπορτο ή δίπορτο και να διαθέτει ρόδες μετακίνησης βαρέως τύπου με ρεγουλατόρους, ώστε να δύναται να μετακινηθεί εντός του χώρου που ευρίσκεται, και να ρυθμίζεται η κλίση του.

3. Οι εξωτερικές διαστάσεις του να είναι μέχρι 700x600x1800 mm (ΠxΒxΥ) για μονόπορτο και μέχρι 1000x800x2100mm (ΠxΒxΥ) για το δεύτερο (διαστάσεις χώρου). Να διαθέτει 5 ράφια με δυνατότητα κύλισης προς τα έξω.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Οι εξωτερικές διαστάσεις του να είναι μέχρι 700x600x1800 mm (ΠxΒxΥ) για μονόπορτο και μέχρι 1000x800x2100mm (ΠxΒxΥ) για το δεύτερο (διαστάσεις χώρου). Να διαθέτει τουλάχιστον 3 ράφια με δυνατότητα κύλισης προς τα έξω και δυνατότητα προσθήκης επιπλέον ραφιών.

9. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας λειτουργίας του, από 0 °C έως +15 °C, ενώ η απόδοση του ψυγείου να είναι τέτοια ώστε με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος 38 °C, η εσωτερική θερμοκρασία του να μην υπερβαίνει τους 4 °C. Η ένδειξη της θερμοκρασίας του θα είναι ψηφιακή, με δυνατότητα ρύθμισής της κατά 1°C (ή υποδιαίρεσεων του 1°C), ελεγχόμενη από κατάλληλο μικροεπεξεργαστή.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας λειτουργίας του, από 2 °C έως +15 °C, ενώ η απόδοση του ψυγείου να είναι τέτοια ώστε με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος 38 °C, η εσωτερική θερμοκρασία του να μην υπερβαίνει τους 4 °C. Η ένδειξη της θερμοκρασίας του θα είναι ψηφιακή, με δυνατότητα ρύθμισής της κατά 1°C (ή υποδιαίρεσεων του 1°C), ελεγχόμενη από κατάλληλο μικροεπεξεργαστή.

Η προϋπολογιστική δαπάνη των 4.960,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% αρκεί μόνο για ένα ψυγείο των 300-400 λίτρων. Για αυτό το λόγο προτείνουμε και την αύξηση του προϋπολογισμού κατά 8.000,00€ σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε και δεύτερο ψυγείο χωρητικότητας >650 lt.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτα Παπαδάκη

AIMED ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

T +302106009573

E-mail info@aimed.gr

2.ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΥΓΕΙΑ ΑΕ

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Κατόπιν προσεκτικής μελέτης των αναρτημένων τεχνικών προδιαγραφών σας στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΨΥΓΕΙΩΝ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ, σας υποβάλλουμε κατωτέρω τις προτάσεις μας που αποσκοπούν στην βελτίωση, καθώς και στο "άνοιγμα" των προδιαγραφών γεγονός που θα επιτρέψει την ευρεία συμμετοχή στον διαγωνισμό και την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος του νοσοκομείου.

Στην προδιαγραφή 3. Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής: Οι εξωτερικές διαστάσεις του να είναι ΠΕΡΙΠΟΥ 600x730x1900h mm για μονόπορτο και ΠΕΡΙΠΟΥ 780x1040x2000h mm για το δεύτερο. Να διαθέτει 5 ράφια με δυνατότητα κύλισης προς τα έξω.

Η προδιαγραφή 4 παραπέμπει σε οικιακού τύπου ψυγείου.

Στους ειδικούς όρους στην προδιαγραφή 3. Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής: Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 37001 και ISO 45001 . Να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε βάσει του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Καραγιάννη Δέσποινα
Τμήμα Πωλήσεων
Ιατρική Μέριμνα & Υγεία Α.Ε.