



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Πολύγυρος: 4-2-2025
Αρ. πρωτ. 1393

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ. Κωνσταντινιά Καμήλαλη
Τηλ: 23713 50207
Email: kamilalik@1157.syzefxis.gov.gr

Προς :
Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα διαβούλευσης με αρ. **2025ΔΙΑΒ29747** επί των Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν την προμήθεια «**ΣΕΤ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ** » (CPV:33100000-1) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, προϋπολογιστικής δαπάνης **16.740,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% ενόψει της κατάρτισης φακέλου για την τελική πρόταση για ένταξη στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027.


Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής ανακοινώνει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών σχετικά με την προμήθεια «**ΣΕΤ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ** » (CPV:33100000-1) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, προϋπολογιστικής δαπάνης **16.740,00€** για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, προϋπολογιστικής δαπάνης **16.740,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% ενόψει της κατάρτισης φακέλου για την τελική πρόταση για ένταξη στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027 όπως αυτά υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό **2025ΔΙΑΒ29747** από τις **17-1-2025** έως τις **1-2-2025**


Συνημμένα :

Σχόλια των Οικονομικών φορέων

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ



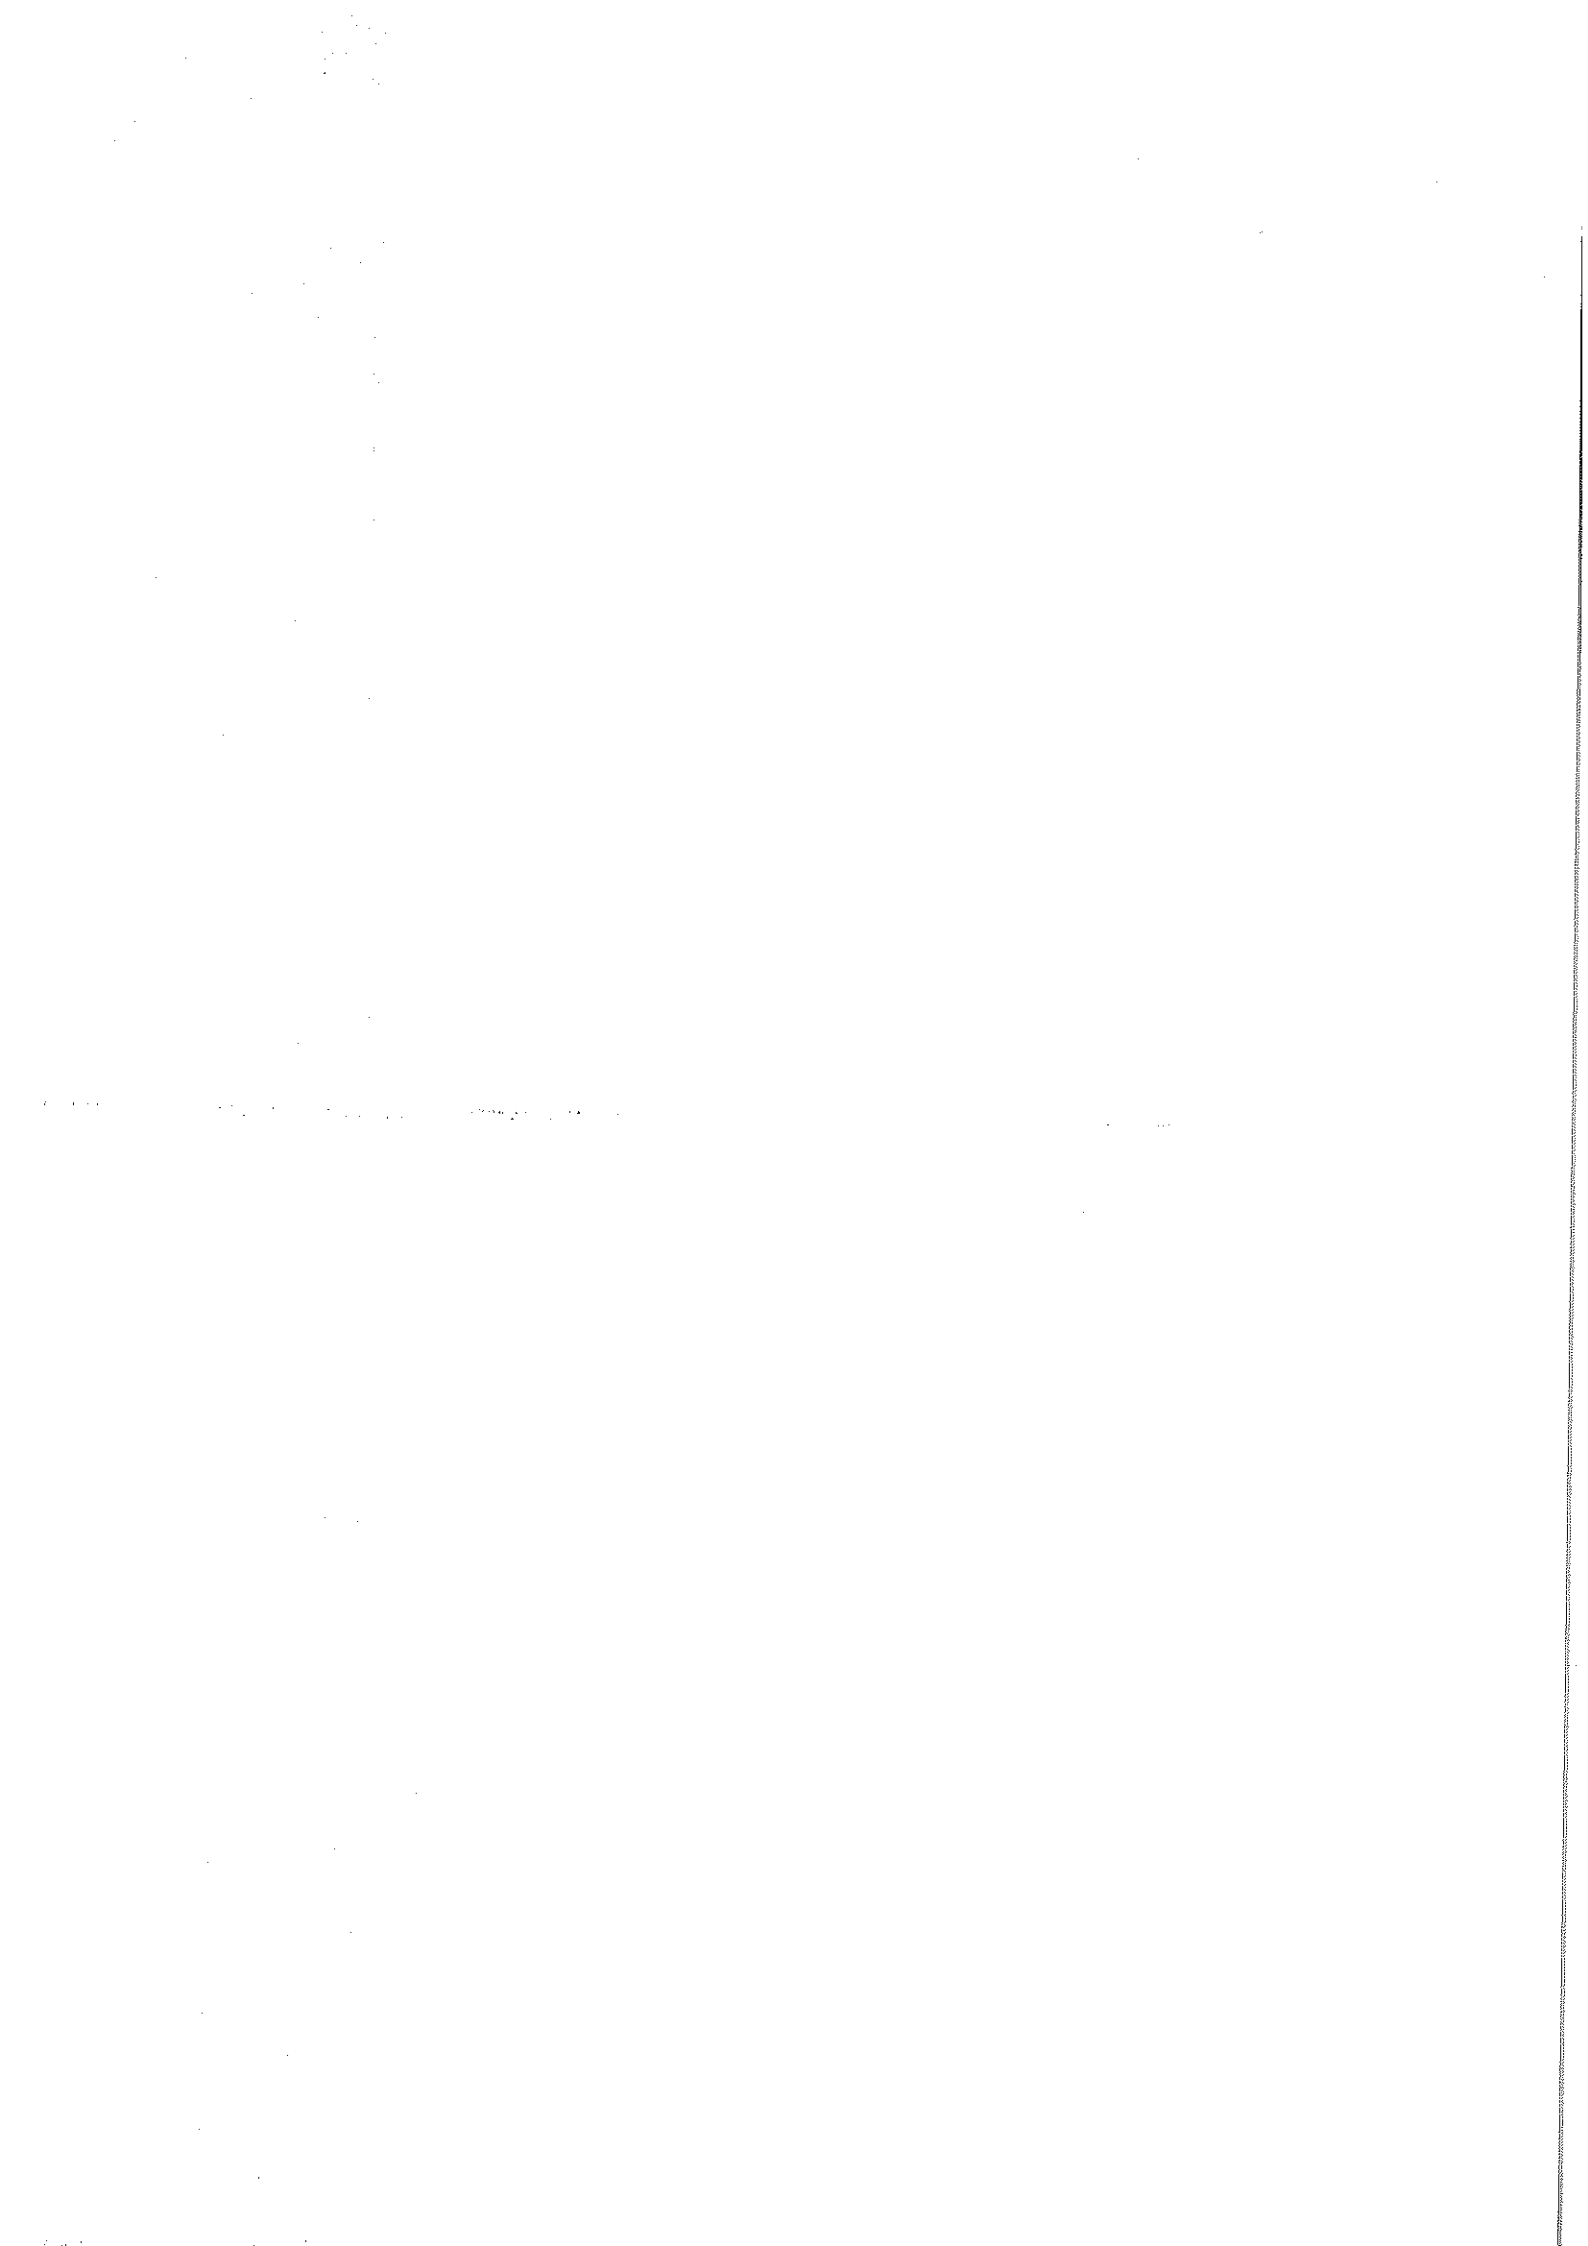

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ

1. ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ

Προς
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ.: LT-0000015746

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2025

Θέμα: Σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών Δημόσιας Διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΣΕΤ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής (2025DIAB29747)

Αξιότιμοι κύριοι,

Καταθέτουμε σχόλια της εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΩΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, επί των τεχνικών προδιαγραφών τεχνικών προδιαγραφών Δημόσιας Διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΣΕΤ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής (2025DIAB29747), ως εξουσιοδοτημένος διανομέας στην Ελλάδα για τον Ιατρικό Εξοπλισμό και Υλικά κατασκευής του Οίκου OLYMPUS Medical Systems Corporation και των συνεργαζόμενων εταιρειών, ως ακολούθως:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΕΤ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΕΤ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ

1.1 Οπτική 12° διαμέτρου 4mm, η οποία να έχει μήκος εργασίας τουλάχιστον 280mm. Οι φακοί να είναι κατασκευασμένοι από γυάλινο στοιχείο εξαιρετικά χαμηλής διασποράς (ED-Extra Low Dispersion) ή αντίστοιχης ποιότητας, για να παρέχουν μεγάλη ευκρίνεια και να μειώνεται στο ελάχιστο η χρωματική εκτροπή. Επίσης, να διαθέτει γυαλί από ζαφείρι για να μη χαράζεται ευκολά, να διαθέτει δακτυλίδι απορρόφησης της υγρασίας και δακτυλίδι από αλουμίνιο για άριστη στεγανοποίηση. Να αποστειρώνεται σε κλίβανο ατμού (autoclavable). Να συνοδεύεται από κυλινδρικό κωτίο προστασίας κατά την διάρκεια αποστείρωσης σε κλίβανο ατμού. Να είναι απολύτως συμβατή με το υπάρχον ρεζεκτοσκόπιο για χρήση υπό φυσιολογικό ορό του χειρουργείου.

1.2 Οπτική 30° διαμέτρου 4mm, η οποία να έχει μήκος εργασίας τουλάχιστον 280mm. Οι φακοί να είναι κατασκευασμένοι από γυάλινο στοιχείο εξαιρετικά χαμηλής διασποράς (ED-Extra Low Dispersion) ή αντίστοιχης ποιότητας, για να παρέχουν μεγάλη ευκρίνεια και να μειώνεται στο ελάχιστο η χρωματική εκτροπή. Επίσης, να διαθέτει γυαλί από ζαφείρι για να μη χαράζεται ευκολά, να διαθέτει δακτυλίδι απορρόφησης της υγρασίας και δακτυλίδι από αλουμίνιο για άριστη στεγανοποίηση. Να αποστειρώνεται σε κλίβανο ατμού (autoclavable). Να συνοδεύεται από κυλινδρικό κωτίο προστασίας κατά την διάρκεια αποστείρωσης σε κλίβανο ατμού. Να είναι απολύτως συμβατή με το υπάρχον ρεζεκτοσκόπιο για χρήση υπό φυσιολογικό ορό του χειρουργείου.

1.3 Οπτική 70° διαμέτρου 4mm, η οποία να έχει μήκος εργασίας τουλάχιστον 280mm. Οι φακοί να είναι κατασκευασμένοι από γυάλινο στοιχείο εξαιρετικά χαμηλής διασποράς (ED-Extra Low Dispersion) ή αντίστοιχης ποιότητας, για να παρέχουν μεγάλη ευκρίνεια και να μειώνεται στο ελάχιστο η χρωματική εκτροπή. Επίσης, να διαθέτει γυαλί από ζαφείρι για να μη χαράζεται ευκολά, να διαθέτει δακτυλίδι απορρόφησης της υγρασίας και δακτυλίδι από αλουμίνιο για άριστη στεγανοποίηση. Να αποστειρώνεται σε κλίβανο ατμού (autoclavable). Να συνοδεύεται από κυλινδρικό κωτίο προστασίας κατά την διάρκεια αποστείρωσης σε κλίβανο ατμού. Να συνοδεύεται από κωτίο αποστείρωσης.

1.4 Θήκη κυστεοσκοπίου 21 Fr. με τυφλό μαντρέν.

1.5 Οπτικό μαντρέν κυστεοσκοπίου 21 Fr.

1.6 Albarran διπλού αυλού και γέφυρα διπλού αυλού.

1.7 Να συνοδεύεται από μια θήκη τοποθέτησης του σετ κυστεοσκοπίου (δυο οπτικές, θήκη κυστεοσκοπίου, οπτικό μαντρέν, Albarran, γέφυρα) με καπάκι για αποστείρωση σε κλίβανο ατμού.

1.8 Για το παραπάνω επεμβατικό κυστεοσκόπιο να προσφερθούν μία (1) λαβίδα σύλληψης και μια βιοψίας οι οποίες να είναι εύκαμπτες, 7 Fr X 330mm.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΕΓΓΥΗΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

- 2.1 Να χορηγείται εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών, αρχόμενη από την τοποθέτηση και έλεγχο καλής λειτουργίας.
- 2.2 Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του μηχανήματος, θα εκπαιδευτούν ιατροί και τεχνικοί του Νοσοκομείου, στην χρήση και συντήρηση αντίστοιχα σε προκαθορισμένο χρόνο.
- 2.3 Κατά την εκπαίδευση θα παραδοθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας και τεχνικής φροντίδας.
- 2.4 Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήματα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον επταετής.
- 2.5 Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλου συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια (όχι μονολεκτικά) και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Επιπλέον, η αναδρομή σε ξενόγλωσσα φυλλάδια, τεχνικά εγχειρίδια, δηλώσεις του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητούμενων στοιχείων θα γίνεται με σαφή αναφορά στην παράγραφο του εγγράφου όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.
- 2.6 Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν το CE Mark πιστοποιημένο από επίσημο φορέα και να είναι ειδικά για την χρήση τους στην ιατρική.

Με εκτίμηση
Σμαράγδα Τάτση
Sales Specialist
Surgical Products
OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS